



KANE258

Analyseur de combustion avec mesure directe de l'O₂, CO et protection de la cellule CO

Guide rapide d'utilisation



KANE258

- 1 Connaître votre KANE258
- 2 Connexions
- 3 Avant l'utilisation
- 4 KANE ASSET MANAGEMENT (KAM)

Merci d'enregistrer votre analyseur sur www.kane.fr et de télécharger le manuel d'utilisation complet.

VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL

1

Connaître votre KANE258




Fonctions des touches

Symbole	Description
	PAUSE - Appuyer brièvement pour maintenir en pause les données actuellement à l'écran (voir la section Barre d'état)
	POMPE - Appuyer longuement pour activer / désactiver la pompe
	NAVIGUER VERS LE HAUT - Appuyer brièvement pour faire défiler vers le haut
	ENTRER - Appuyer pour valider
	NAVIGUER VERS LE BAS - Appuyer brièvement pour faire défiler vers le bas
	SAUVEGARDER - Appuyer longuement pour stocker les données
	IMPRIMER - Appuyer brièvement pour imprimer un rapport

2

Connexions

Connexion chargeur de batteries

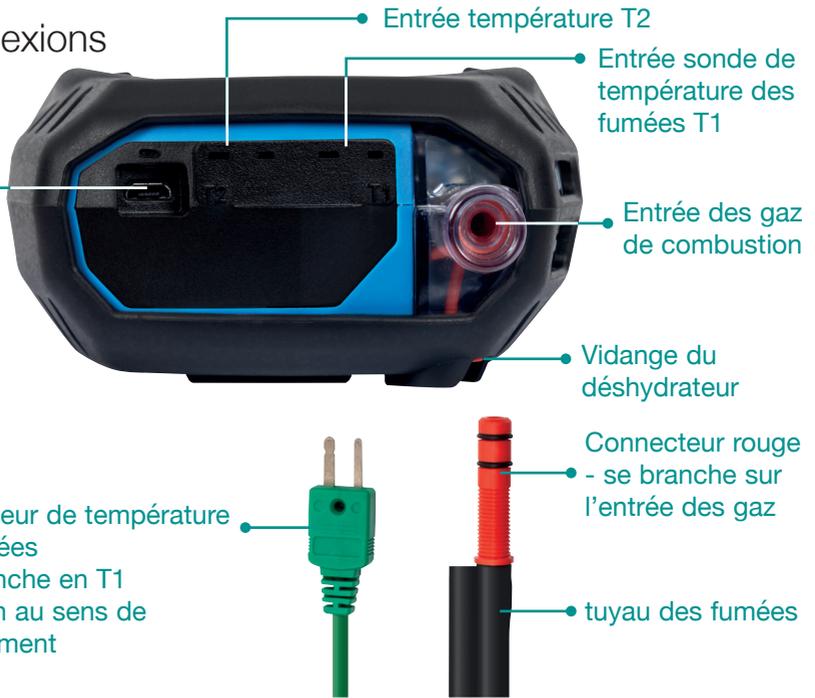

Entrée température T2

Entrée sonde de température des fumées T1

Entrée des gaz de combustion

Vidange du déshydrateur

Connecteur rouge
- se branche sur l'entrée des gaz

Connecteur de température des fumées
- se branche en T1
Attention au sens de branchement

tuyau des fumées

3

Avant l'utilisation

Vérifier que :

Le filtre à particules ne soit pas sale ; Le déshydrateur et la sonde ne contiennent pas d'eau ;

Le déshydrateur et son bouchon rouge soient bien présents sur l'analyseur ; Tuyau de la sonde de fumée soit connecté à l'entrée des gaz de combustion ; Connecteur de température de la sonde de fumée soit connecté en entrée de température T1

Purge d'air frais

Placer la sonde de fumée à l'air frais et appuyer sur **On/Off**. L'analyseur se calibre automatiquement pendant 30 secondes

Sélectionner **CO/CO₂** sur le commutateur rotatif - en lecture d'air frais CO = 0ppm.

Sélectionner **O₂ / Eff** sur le commutateur rotatif - en lecture d'air frais O₂ = 20,9%.

Sélectionner **Status** sur le commutateur rotatif pour choisir votre combustible

Chargement des batteries rechargeables NiMH

Éteindre l'analyseur

Connecter le chargeur - l'indicateur de charge s'allume

4

KANE ASSET MANAGER (KAM)



Enregistrer votre analyseur KANE pour créer votre tableau de bord KAM :

- ★ Réservation en ligne de votre prestation SAV sur www.kane.fr
- ★ Informations spécifiques de votre produit, offres spéciales et remises
- ★ Rappel automatique à l'échéance de l'étalonnage de votre analyseur
- ★ **RENOVI GRATUIT** de votre analyseur KANE en révision
- ★ **Révision le jour même de son arrivée***

*Hors analyseurs série "9"

Utilisez les 11 chiffres

88
182920002



Veuillez **enregistrer** votre analyseur sur www.kane.fr et télécharger le manuel d'instructions complet depuis votre tableau de bord KAM

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL ET LES AVERTISSEMENTS AVANT UTILISATION



Service Client

03 27 80 88 54

www.kane.fr

Email : infos@kane.fr

Kane International Limited

299 rue St Sulpice -

Bâtiment Arsenal

59500 DOUAI

Email : sav@kane.fr

Suivez-nous sur ...



KANE et le logo KANE (enregistré au Royaume-Uni et partout dans le monde) sont des marques commerciales de Kane Group Limited, utilisées sous licence. Toutes les autres marques sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

© 2020 Kane International Limited.